


# FM-8C型全自动冰点渗透压计 渗透压摩尔浓度测定仪

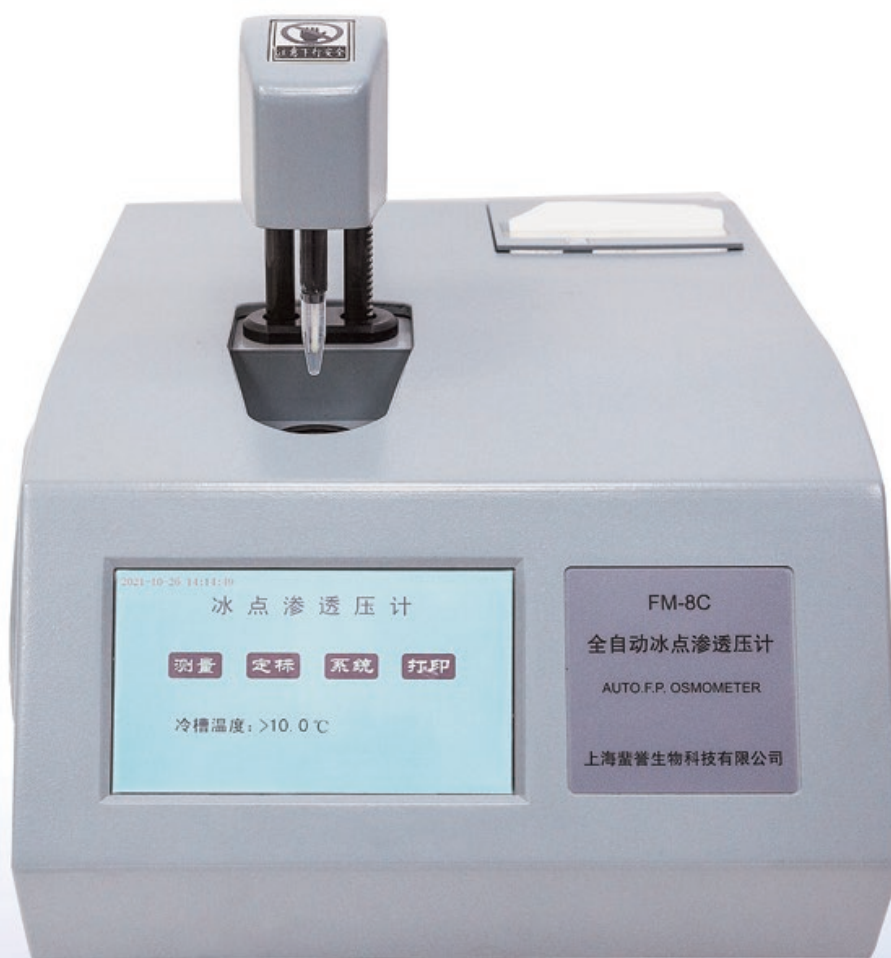

上海蜚誉生物科技有限公司

# FM-8C型全自动冰点渗透压计

## 渗透压摩尔浓度测定仪

### 技术指标:

1. 测量范围:[0-2000)mOsm/kg:
2. 样品量:0.5ml:
3. 测量基本误差:  
≤300mOsm/kg不大于±3mOsm/kg  
>300mOsm/kg不大于1%,
4. 重复误差:[CV)不大于1%
5. 测量速度:<3分/次:
6. 内置打印机:
7. 分辨率:1mOsm/kg:
8. 制冷方式:半导体制冷
9. 电源:AC220V.50Hz.280W
- 10.重量:15kg:
- 11.自动识别早冻和不冻等测量故障

### 药检应用:

- 1.各级药检机构及制药厂质检部门按国家药典规定项目的检测;
- 2.新药研发的渗透压评价;
- 3.贯彻执行中华人民共和国制药机械行业标准JB/T20155-2013

### 教学等应用:

- 1.医、药、农、牧、渔等专业高等教育的教学实验、科研与生产;
- 2.食品、乳制品、功能饮料等行业。

上海蜚誉生物科技有限公司

地址: 中国(上海)自由贸易试验区

临港新片区万松路319弄15号4楼A区

电话: 13361964099 021-54326298

传真: 021-54326298